



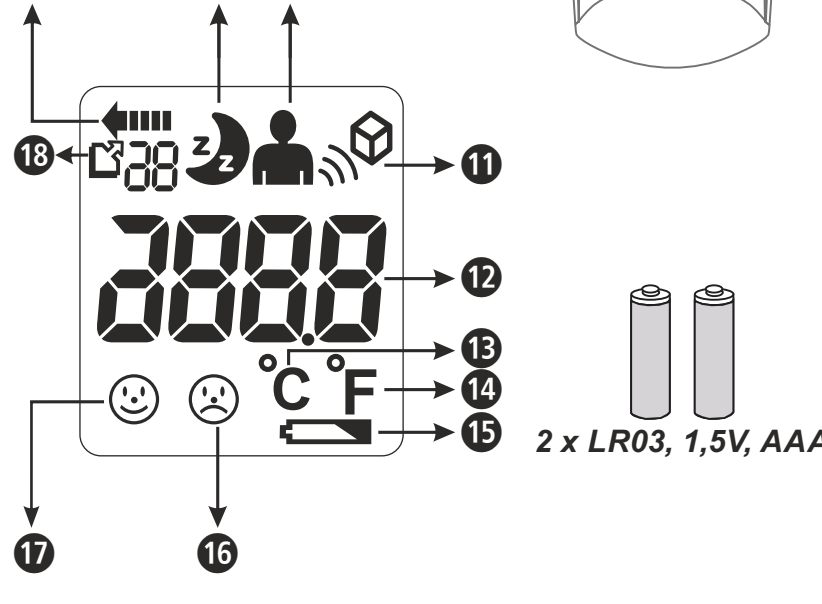

Infra-röd-febertermometer TM-65E
Θερμόμετρο πυρετού με υπέρυθρες TM-65E

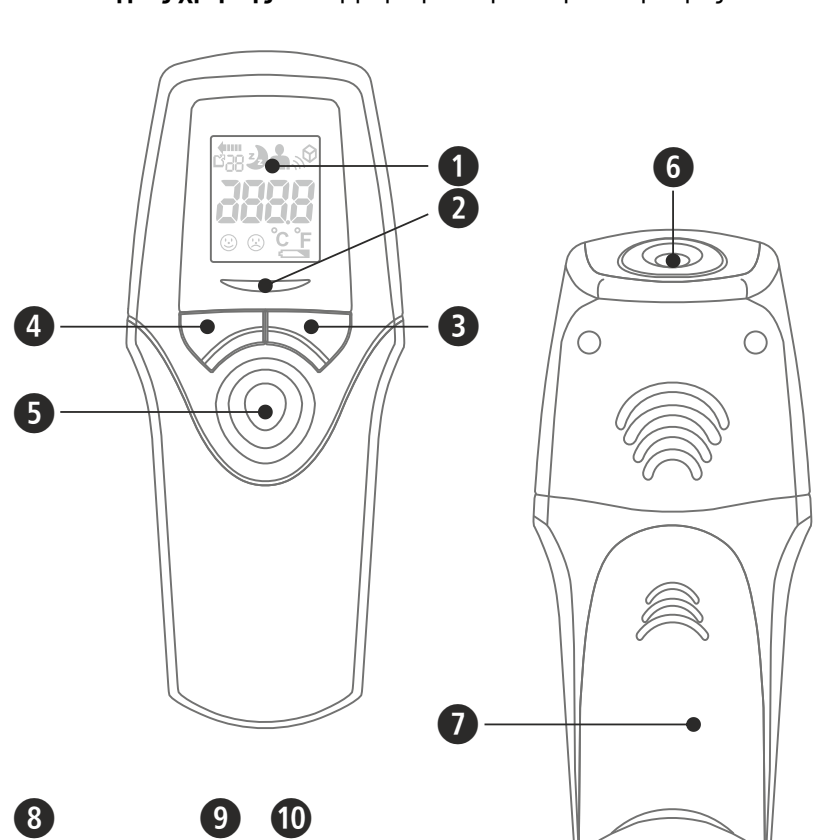

2 x LR03, 1.5V, AAA

Teckenförklaring Επεξήγηση συμβόλων

VIKTIGT ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ

Om anvisningarna i bruksanvisningen inte följs kan det leda till svåra personskador eller skador på apparaten. Även den tryckningen av örhörningen avseende att användningen, måste användas enligt bruksanvisningen för att undvika skador på apparaten. Använd alltid bruksanvisningen för att undvika skador på apparaten.

VARNING ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Varningssystemet måste beaktas, annars kan det finnas risk för personskador. Använd alltid bruksanvisningen för att undvika skador på apparaten. Använd alltid bruksanvisningen för att undvika skador på apparaten.

OBSERVERA ΠΡΟΣΧΩΝ

De här anvisningarna måste beaktas, annars kan det finnas risk för skador på apparaten. Använd alltid bruksanvisningen för att undvika skador på apparaten. Använd alltid bruksanvisningen för att undvika skador på apparaten.

ANVISNING ΥΠΟΔΕΙΞΗ

De här texterna innehåller praktisk information om installation eller användning. Använd alltid bruksanvisningen för att undvika skador på apparaten. Använd alltid bruksanvisningen för att undvika skador på apparaten.

Apparatklassificering: modell BF Ταξινόμηση συσκευής: Τύπος BF

LOT-nummer Αριθμός LOT


Tillverkare Παραγωγός

Tillverkningsdatum Ημερομηνία κατασκευής

CE 0297



Infra-röd-febertermometer TM-65E
Θερμόμετρο πυρετού με υπέρυθρες TM-65E

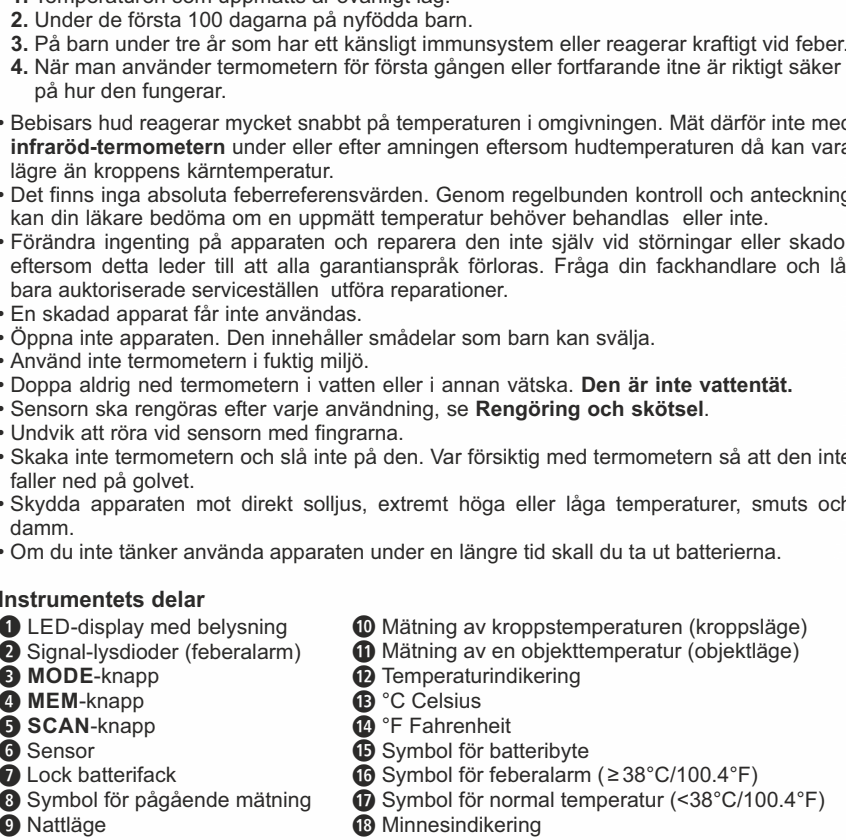

2 x LR03, 1.5V, AAA

Teckenförklaring Επεξήγηση συμβόλων

VARNING

Se till att förpackningsmaterial i plast hanteras utom räckhåll för barn! Κηλυσήνισκή

Leversansfång och förpackning

Kontrollera först om apparaten är komplett och att den inte uppvisar några skador. I tvcksamma fall ska apparaten inte tas i bruk utan skickas in till återförsäljaren eller ett serviceställe.

Följande delar skall medfölja vid leverans:

- 1 ecomed Infra-röd-febertermometer TM-65E

- 2 batterier (typ AAA, LR03) 1,5V

- 1 bruksanvisning

Extrafunktion

Förutom för mätning av kroppstemperatur kan den infraröda febertermometern TM-65E från ecomed även användas för mätning av kroppstemperatur (t.ex. omgivningstemperatur, vätskors temperatur, ytemperatur). Med denna funktion kan mätningar göras inom området 0° till 100° Celsius (32°F - 212°F).

Börja använda: lägga in/ta ur batterier

Yra batterier måste läggas in för användningen resp. när symbolen för batteribyte visas efter en viss användningstid. Om symbolen för batteribyte visas tillsammans med indikeringen "Lo" i displayen så måste nya batterier läggas in före nästa mätning. Använd 2 nya 1,5 V batterier (typ LR03, AAA) till detta.

Ta ur: ta av locket till batterifacket 1 genom att skjuta det lätt neråt och dra av det.

Ta ut batterierna. Långa: lägg in två nya 1,5 V batterier (typ LR03, AAA). Var noga med att viklet här batterierna ligger (bild i batterifacket). Sätt tillbaka locket 2 igen.


ANVISNING

SAKERHETSANVISNINGAR FÖR BATTERI

• Monterar inte isär batterierna!
• Rengör vid behov batteriernas och apparatens kontakter innan batterierna sätts in!
• Ta genast ut tomma batterier ur apparaten!
• Risk för läckage - undvik kontakt med hud, ögon och slemhinnor! Om du får batterisyra på något av ovanstående ställen: skölj genast rikligt med rent vatten och kontakta läkare!



Infra-röd-febertermometer TM-65E
Θερμόμετρο πυρετού με υπέρυθρες TM-65E

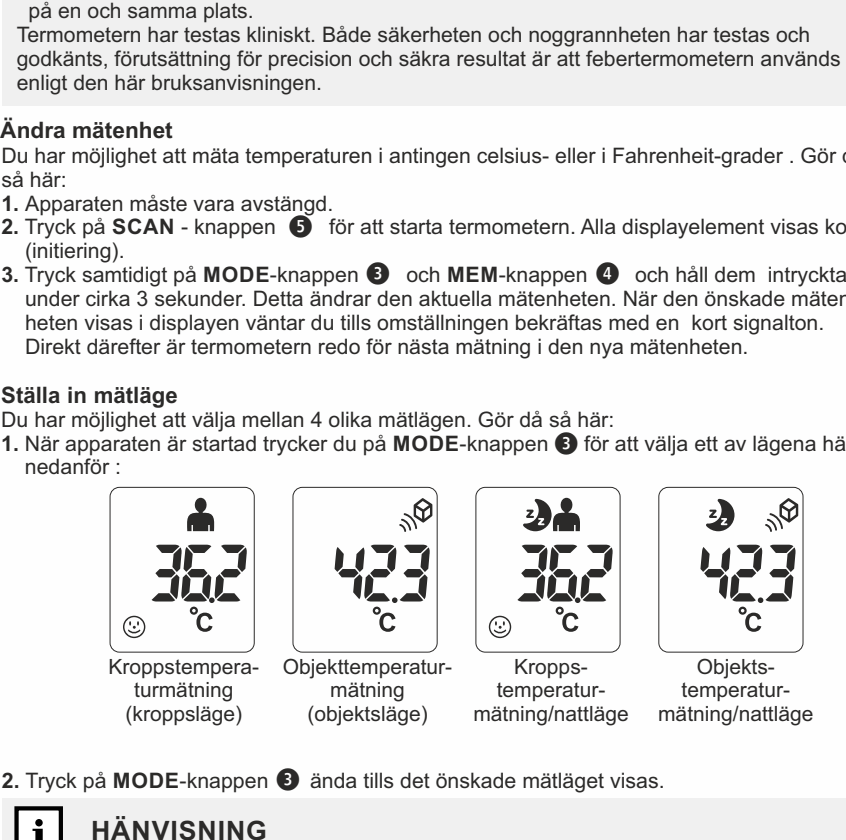

2 x LR03, 1.5V, AAA

Teckenförklaring Επεξήγηση συμβόλων

VARNING

Se till att förpackningsmaterial i plast hanteras utom räckhåll för barn! Κηλυσήνισκή

Leversansfång och förpackning

Kontrollera först om apparaten är komplett och att den inte uppvisar några skador. I tvcksamma fall ska apparaten inte tas i bruk utan skickas in till återförsäljaren eller ett serviceställe.

Följande delar skall medfölja vid leverans:

- 1 ecomed Infra-röd-febertermometer TM-65E

- 2 batterier (typ AAA, LR03) 1,5V

- 1 bruksanvisning

Extrafunktion

Förutom för mätning av kroppstemperatur kan den infraröda febertermometern TM-65E från ecomed även användas för mätning av kroppstemperatur (t.ex. omgivningstemperatur, vätskors temperatur, ytemperatur). Med denna funktion kan mätningar göras inom området 0° till 100° Celsius (32°F - 212°F).

Börja använda: lägga in/ta ur batterier

Yra batterier måste läggas in för användningen resp. när symbolen för batteribyte visas efter en viss användningstid. Om symbolen för batteribyte visas tillsammans med indikeringen "Lo" i displayen så måste nya batterier läggas in före nästa mätning. Använd 2 nya 1,5 V batterier (typ LR03, AAA) till detta.

Ta ur: ta av locket till batterifacket 1 genom att skjuta det lätt neråt och dra av det.


Ta ut batterierna. Långa: lägg in två nya 1,5 V batterier (typ LR03, AAA). Var noga med att viklet här batterierna ligger (bild i batterifacket). Sätt tillbaka locket 2 igen.

ANVISNING


SAKERHETSANVISNINGAR FÖR BATTERI

• Monterar inte isär batterierna!
• Rengör vid behov batteriernas och apparatens kontakter innan batterierna sätts in!
• Ta genast ut tomma batterier ur apparaten!
• Risk för läckage - undvik kontakt med hud, ögon och slemhinnor! Om du får batterisyra på något av ovanstående ställen: skölj genast rikligt med rent vatten och kontakta läkare!

CE 0297

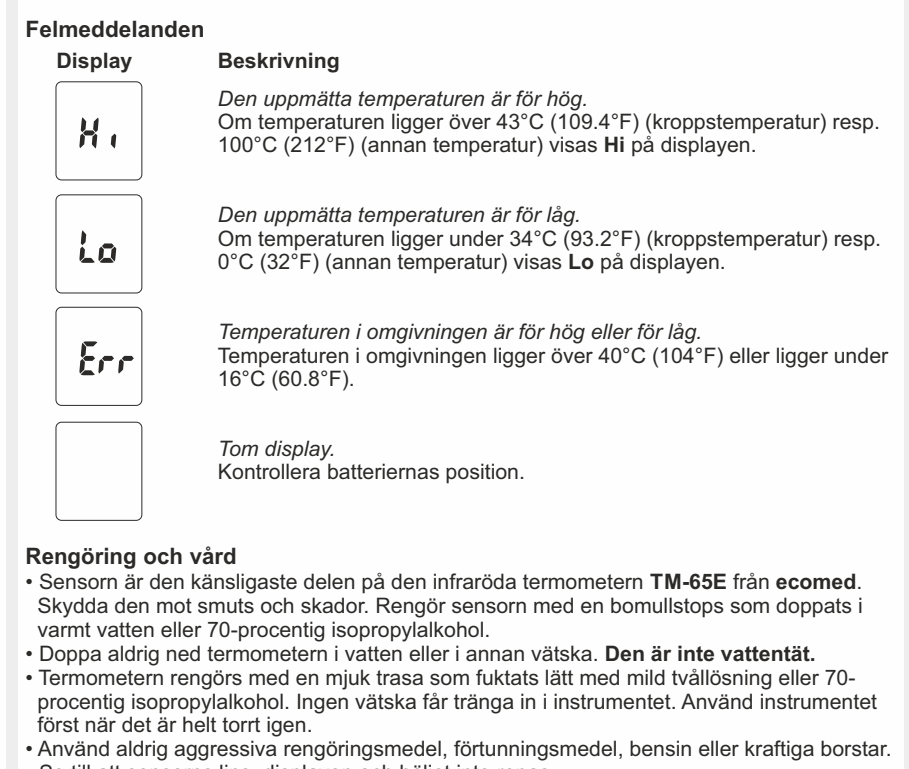

Infra-röd-febertermometer TM-65E
Θερμόμετρο πυρετού με υπέρυθρες TM-65E

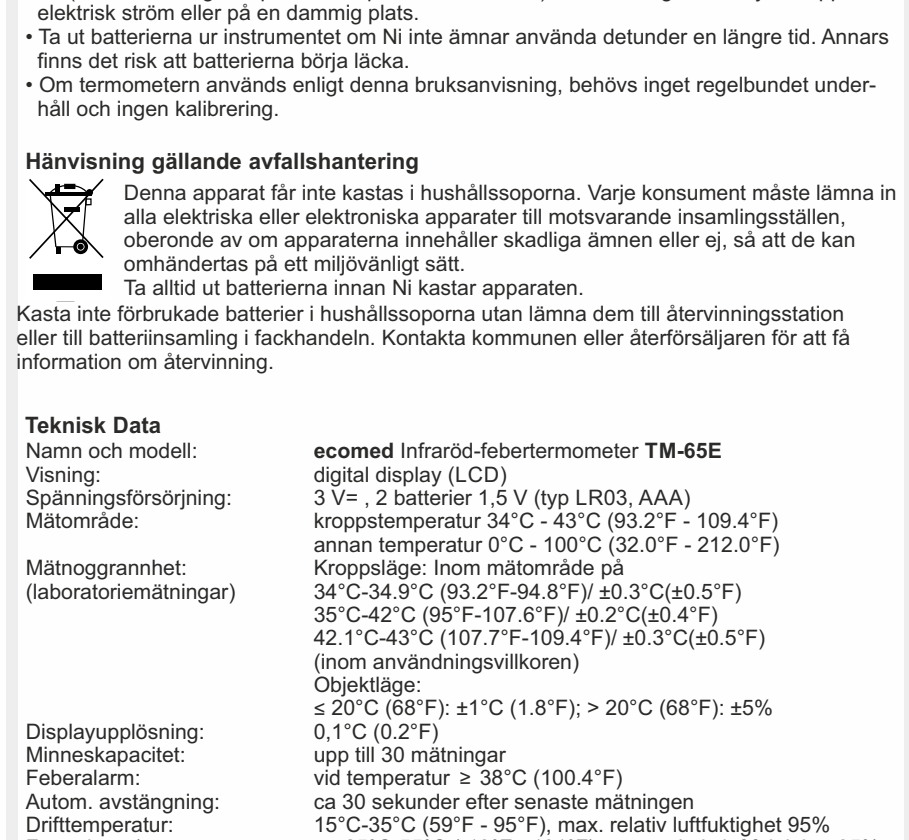

2 x LR03, 1.5V, AAA

Teckenförklaring Επεξήγηση συμβόλων

VARNING

Se till att förpackningsmaterial i plast hanteras utom räckhåll för barn! Κηλυσήνισκή

Leversansfång och förpackning

Kontrollera först om apparaten är komplett och att den inte uppvisar några skador. I tvcksamma fall ska apparaten inte tas i bruk utan skickas in till återförsäljaren eller ett serviceställe.

Följande delar skall medfölja vid leverans:

- 1 ecomed Infra-röd-febertermometer TM-65E

- 2 batterier (typ AAA, LR03) 1,5V

- 1 bruksanvisning

Extrafunktion

Förutom för mätning av kroppstemperatur kan den infraröda febertermometern TM-65E från ecomed även användas för mätning av kroppstemperatur (t.ex. omgivningstemperatur, vätskors temperatur, ytemperatur). Med denna funktion kan mätningar göras inom området 0° till 100° Celsius (32°F - 212°F).

Börja använda: lägga in/ta ur batterier

Yra batterier måste läggas in för användningen resp. när symbolen för batteribyte visas efter en viss användningstid. Om symbolen för batteribyte visas tillsammans med indikeringen "Lo" i displayen så måste nya batterier läggas in före nästa mätning. Använd 2 nya 1,5 V batterier (typ LR03, AAA) till detta.

Ta ur: ta av locket till batterifacket 1 genom att skjuta det lätt neråt och dra av det.


Ta ut batterierna. Långa: lägg in två nya 1,5 V batterier (typ LR03, AAA). Var noga med att viklet här batterierna ligger (bild i batterifacket). Sätt tillbaka locket 2 igen.

ANVISNING


SAKERHETSANVISNINGAR FÖR BATTERI

• Monterar inte isär batterierna!
• Rengör vid behov batteriernas och apparatens kontakter innan batterierna sätts in!
• Ta genast ut tomma batterier ur apparaten!
• Risk för läckage - undvik kontakt med hud, ögon och slemhinnor! Om du får batterisyra på något av ovanstående ställen: skölj genast rikligt med rent vatten och kontakta läkare!

CE 0297

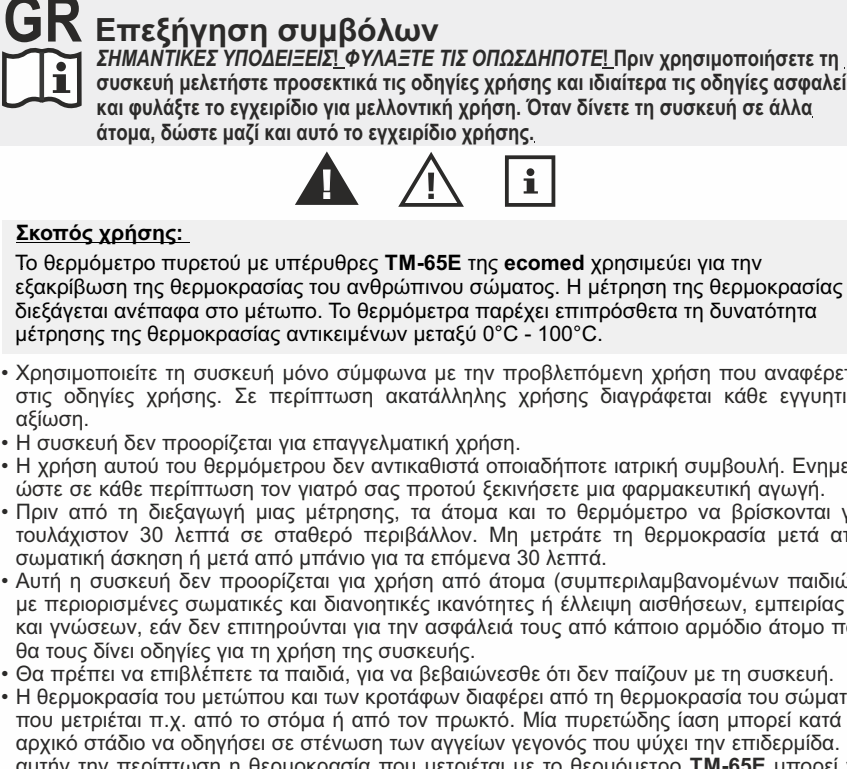

Infra-röd-febertermometer TM-65E
Θερμόμετρο πυρετού με υπέρυθρες TM-65E

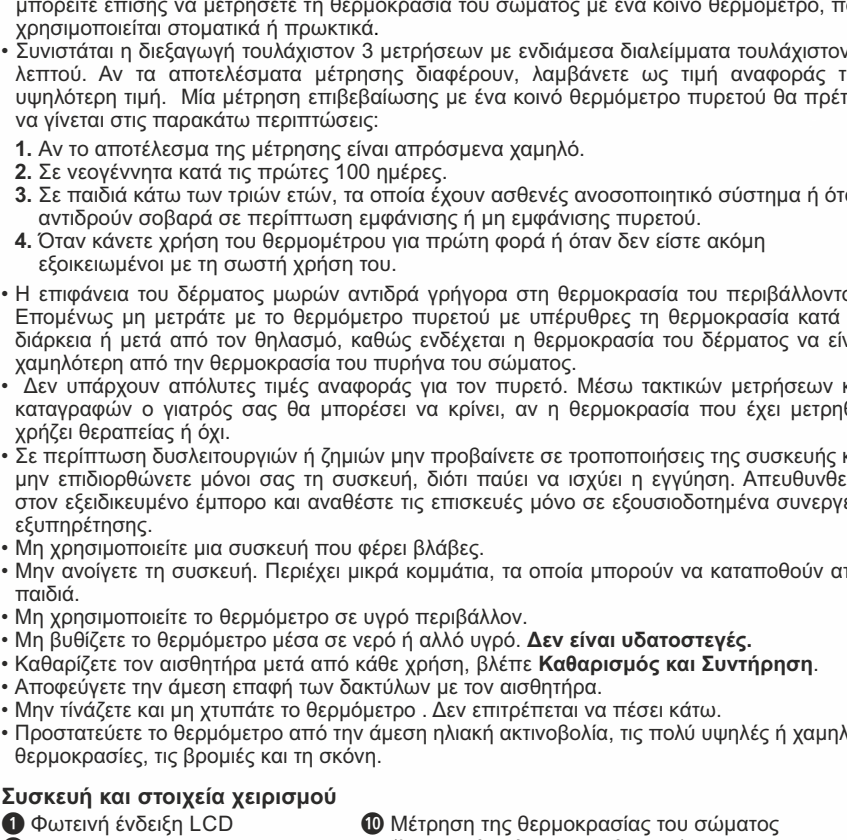

2 x LR03, 1.5V, AAA

Teckenförklaring Επεξήγηση συμβόλων

VARNING

Se till att förpackningsmaterial i plast hanteras utom räckhåll för barn! Κηλυσήνισκή

Leversansfång och förpackning

Kontrollera först om apparaten är komplett och att den inte uppvisar några skador. I tvcksamma fall ska apparaten inte tas i bruk utan skickas in till återförsäljaren eller ett serviceställe.

Följande delar skall medfölja vid leverans:

- 1 ecomed Infra-röd-febertermometer TM-65E

- 2 batterier (typ AAA, LR03) 1,5V

- 1 bruksanvisning

Extrafunktion

Förutom för mätning av kroppstemperatur kan den infraröda febertermometern TM-65E från ecomed även användas för mätning av kroppstemperatur (t.ex. omgivningstemperatur, vätskors temperatur, ytemperatur). Med denna funktion kan mätningar göras inom området 0° till 100° Celsius (32°F - 212°F).

Börja använda: lägga in/ta ur batterier

Yra batterier måste läggas in för användningen resp. när symbolen för batteribyte visas efter en viss användningstid. Om symbolen för batteribyte visas tillsammans med indikeringen "Lo" i displayen så måste nya batterier läggas in före nästa mätning. Använd 2 nya 1,5 V batterier (typ LR03, AAA) till detta.

Ta ur: ta av locket till batterifacket 1 genom att skjuta det lätt neråt och dra av det.


Ta ut batterierna. Långa: lägg in två nya 1,5 V batterier (typ LR03, AAA). Var noga med att viklet här batterierna ligger (bild i batterifacket). Sätt tillbaka locket 2 igen.

ANVISNING


SAKERHETSANVISNINGAR FÖR BATTERI

• Monterar inte isär batterierna!
• Rengör vid behov batteriernas och apparatens kontakter innan batterierna sätts in!
• Ta genast ut tomma batterier ur apparaten!
• Risk för läckage - undvik kontakt med hud, ögon och slemhinnor! Om du får batterisyra på något av ovanstående ställen: skölj genast rikligt med rent vatten och kontakta läkare!

CE 0297

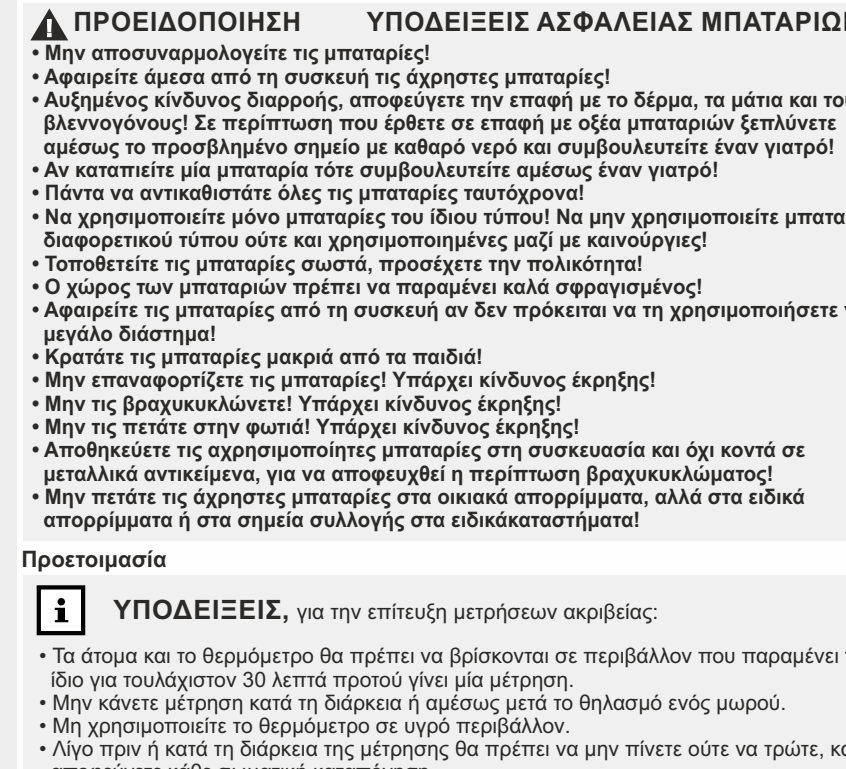

Infra-röd-febertermometer TM-65E
Θερμόμετρο πυρετού με υπέρυθρες TM-65E

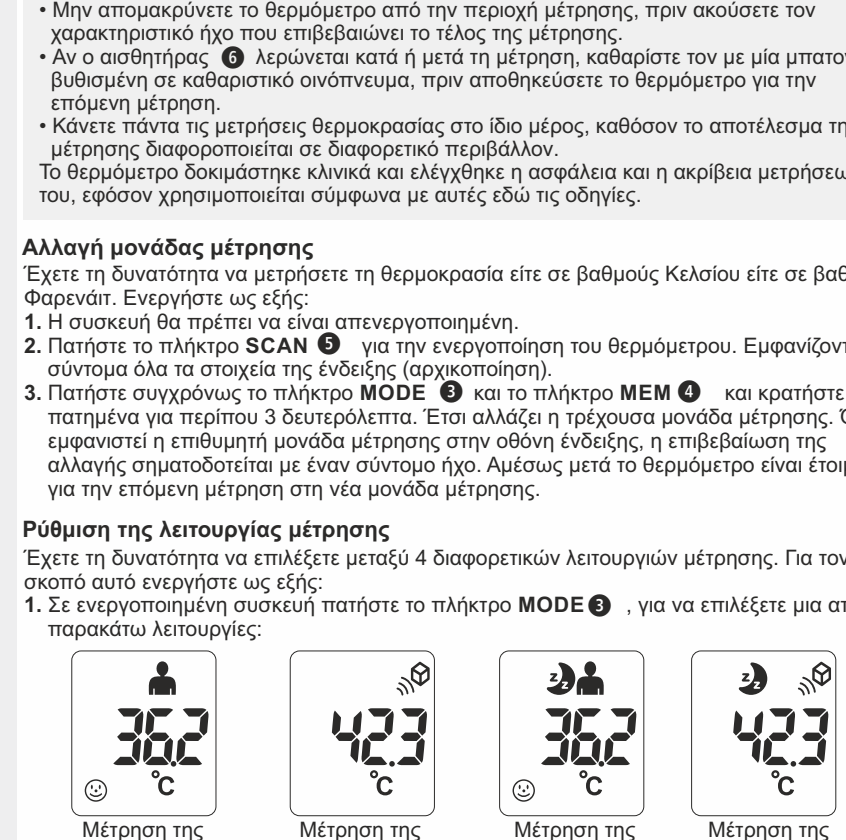

2 x LR03, 1.5V, AAA

Teckenförklaring Επεξήγηση συμβόλων

VARNING

Se till att förpackningsmaterial i plast hanteras utom räckhåll för barn! Κηλυσήνισκή

Leversansfång och förpackning

Kontrollera först om apparaten är komplett och att den inte uppvisar några skador. I tvcksamma fall ska apparaten inte tas i bruk utan skickas in till återförsäljaren eller ett serviceställe.

Följande delar skall medfölja vid leverans:

- 1 ecomed Infra-röd-febertermometer TM-65E

- 2 batterier (typ AAA, LR03) 1,5V

- 1 bruksanvisning

Extrafunktion

Förutom för mätning av kroppstemperatur kan den infraröda febertermometern TM-65E från ecomed även användas för mätning av kroppstemperatur (t.ex. omgivningstemperatur, vätskors temperatur, ytemperatur). Med denna funktion kan mätningar göras inom området 0° till 100° Celsius (32°F - 212°F).

Börja använda: lägga in/ta ur batterier

Yra batterier måste läggas in för användningen resp. när symbolen för batteribyte visas efter en viss användningstid. Om symbolen för batteribyte visas tillsammans med indikeringen "Lo" i displayen så måste nya batterier läggas in före nästa mätning. Använd 2 nya 1,5 V batterier (typ LR03, AAA) till detta.

Ta ur: ta av locket till batterifacket 1 genom att skjuta det lätt neråt och dra av det.


Ta ut batterierna. Långa: lägg in två nya 1,5 V batterier (typ LR03, AAA). Var noga med att viklet här batterierna ligger (bild i batterifacket). Sätt tillbaka locket 2 igen.

ANVISNING


SAKERHETSANVISNINGAR FÖR BATTERI

• Monterar inte isär batterierna!
• Rengör vid behov batteriernas och apparatens kontakter innan batterierna sätts in!
• Ta genast ut tomma batterier ur apparaten!
• Risk för läckage - undvik kontakt med hud, ögon och slemhinnor! Om du får batterisyra på något av ovanstående ställen: skölj genast rikligt med rent vatten och kontakta läkare!

CE 0297

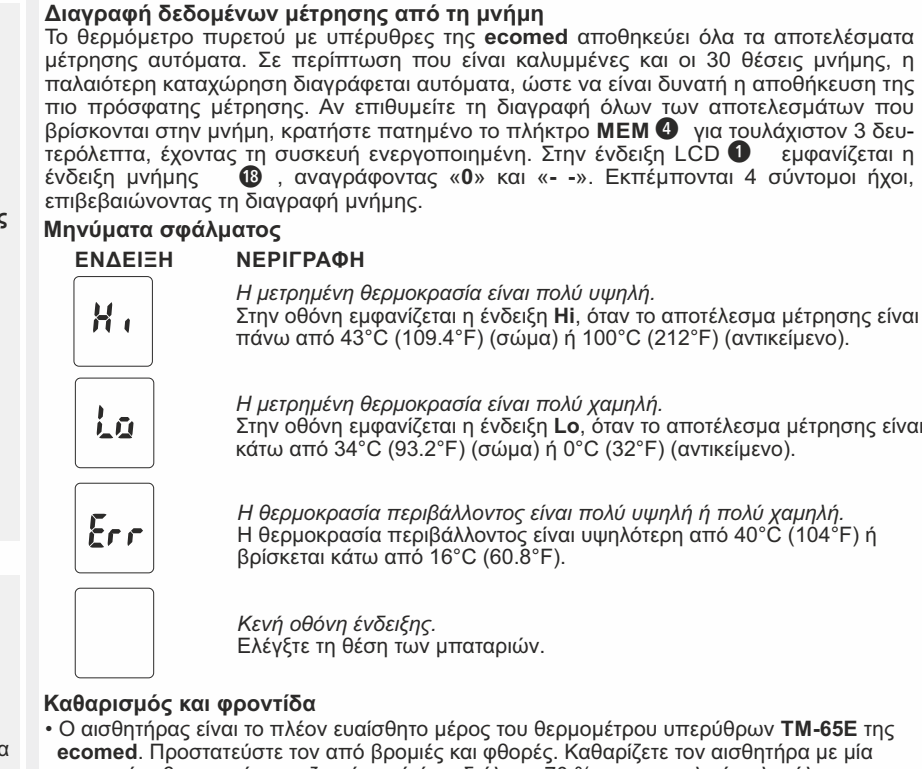

Infra-röd-febertermometer TM-65E
Θερμόμετρο πυρετού με υπέρυθρες TM-65E

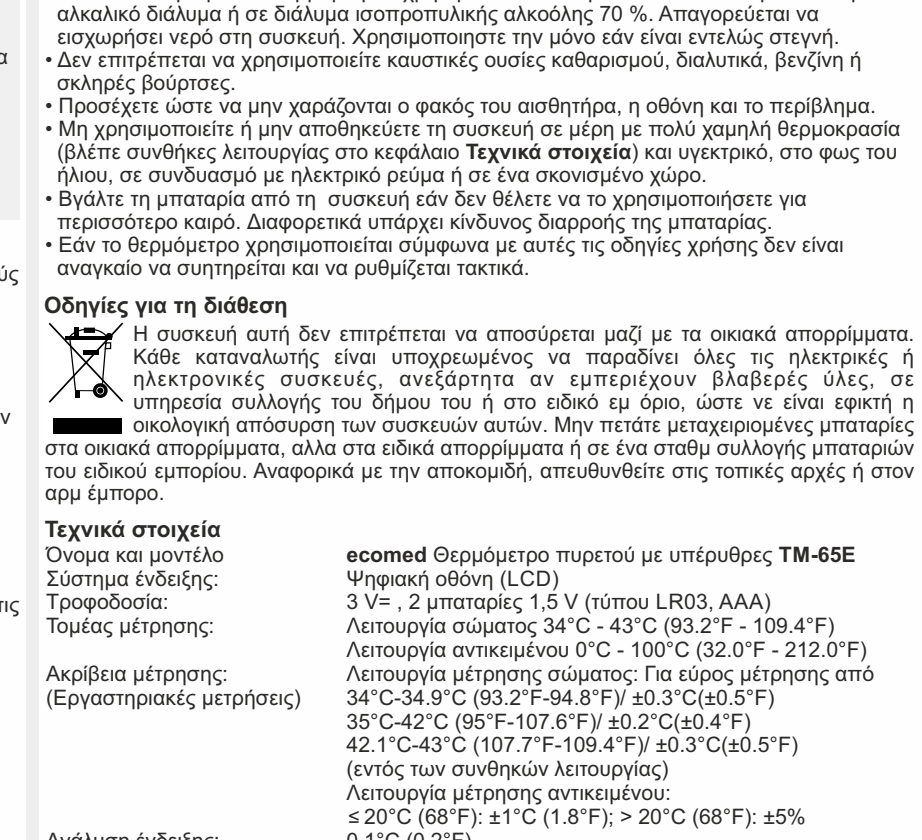

2 x LR03, 1.5V, AAA

Teckenförklaring Επεξήγηση συμβόλων

VARNING

Se till att förpackningsmaterial i plast hanteras utom räckhåll för barn! Κηλυσήνισκή

Leversansfång och förpackning

Kontrollera först om apparaten är komplett och att den inte uppvisar några skador. I tvcksamma fall ska apparaten inte tas i bruk utan skickas in till återförsäljaren eller ett serviceställe.

Följande delar skall medfölja vid leverans:

- 1 ecomed Infra-röd-febertermometer TM-65E

- 2 batterier (typ AAA, LR03) 1,5V

- 1 bruksanvisning

Extrafunktion

Förutom för mätning av kroppstemperatur kan den infraröda febertermometern TM-65E från ecomed även användas för mätning av kroppstemperatur (t.ex. omgivningstemperatur, vätskors temperatur, ytemperatur). Med denna funktion kan mätningar göras inom området 0° till 100° Celsius (32°F - 212°F).

Börja använda: lägga in/ta ur batterier

Yra batterier måste läggas in för användningen resp. när symbolen för batteribyte visas efter en viss användningstid. Om symbolen för batteribyte visas tillsammans med indikeringen "Lo" i displayen så måste nya batterier läggas in före nästa mätning. Använd 2 nya 1,5 V batterier (typ LR03, AAA) till detta.

Ta ur: ta av locket till batterifacket 1 genom att skjuta det lätt neråt och dra av det.

Ta ut batterierna. Långa: lägg in två nya 1,5 V batterier (typ LR03, AAA). Var noga med att viklet här batterierna ligger (bild i batterifacket). Sätt tillbaka locket 2 igen.

ANVISNING

SAKERHETSANVISNINGAR FÖR BATTERI

• Monterar inte isär batterierna!
• Rengör vid behov batteriernas och apparatens kontakter innan batterierna sätts in!
• Ta genast ut tomma batterier ur apparaten!
• Risk för läckage - undvik kontakt med hud, ögon och slemhinnor! Om du får batterisyra på något av ovanstående ställen: skölj genast rikligt med rent vatten och kontakta läkare!

CE 0297

